



RESULTADOS A LARGO PLAZO CON BIOPROTESIS MITROFLOW

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Juan José Otero Forero, Arantza Guzón Rementería, José Manuel Villaescusa Catalán, Gemma Sánchez Espín, María José Mataró López, Carlos Porras Martín, José María Melero Tejedor

INTRODUCCIÓN



Los resultados a largo plazo de las bioprótesis Mitroflow a largo plazo han sido cuestionados, sobre todo en tamaños pequeños y en la posibilidad de tratamiento percutáneo posterior. Sin embargo, los resultados apreciados en nuestro centro impresionaban como diferentes

MATERIAL Y MÉTODOS

Se recogen los resultados en cuanto a durabilidad a largo plazo de esta prótesis. Nuestra serie consta de 128 pacientes, intervenidos entre 2011 y 2017, con un 100% de seguimiento clínico y ecocardiográfico hasta junio de 2019.

RESULTADOS

El 80% de las prótesis correspondieron a tamaños pequeños (19 y 21). La mortalidad en la serie es del 32%, mayoritariamente de causa extracardíaca. Solo encontramos un caso de degeneración precoz (8.5 años), que requirió de TAVI vía femoral.

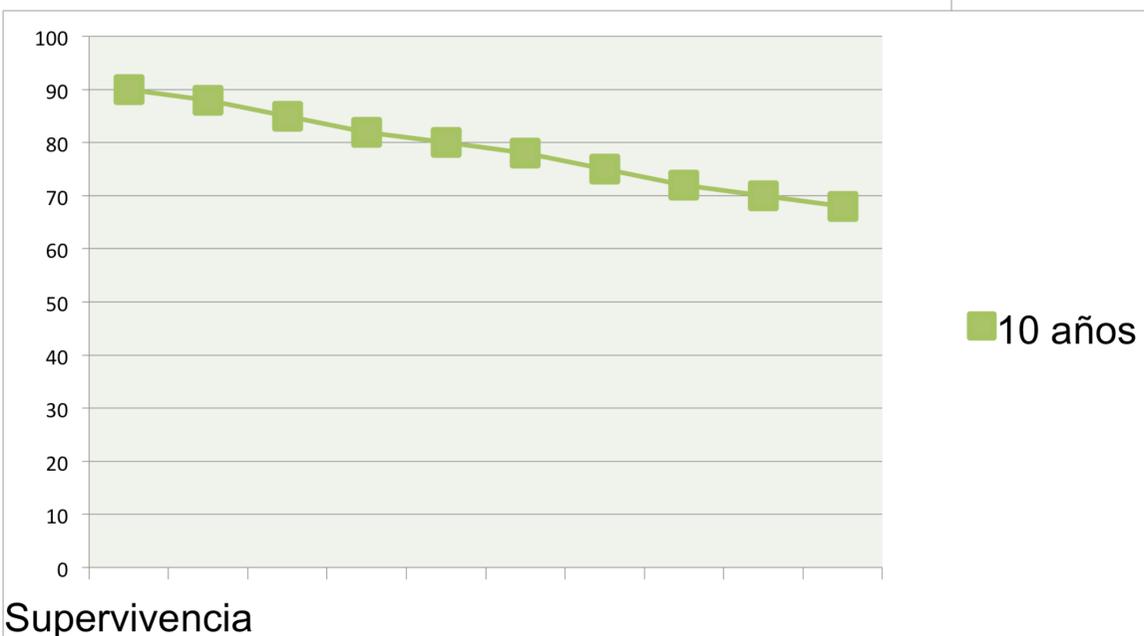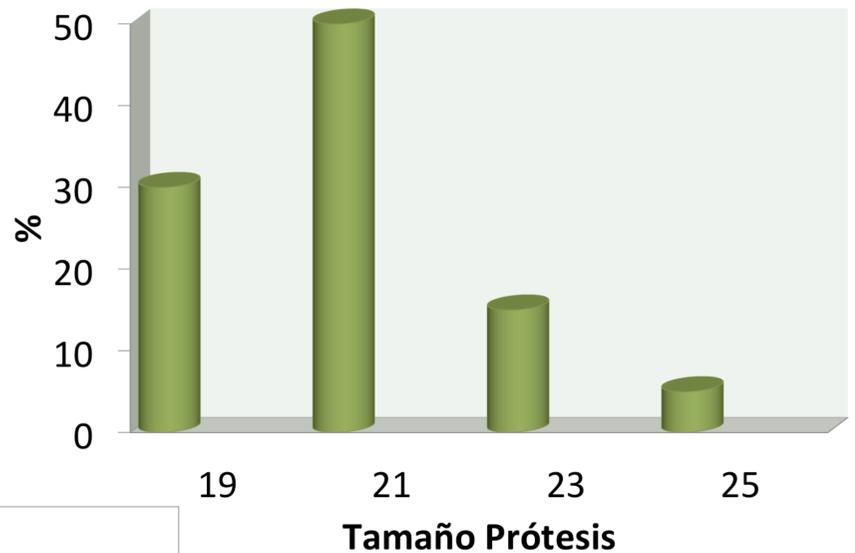

CONCLUSIONES

En nuestra serie no se aprecia una degeneración acelerada de estas prótesis, observándose una durabilidad adecuada al menos en nuestro periodo de seguimiento.

Serían necesarios estudios comparativos, extensos e incluso prospectivos para comprobar estos resultados.